REMEDI

ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

КАК ЗАПИСАТЬ КТГ ДОМА

Пошаговая инструкция
для фетального монитора «Илифия»

мобильно

15-45 минут

отправка врачу

USONTEC

REMEDI

ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

КАК ЗАПИСАТЬ КТГ ДОМА

Пошаговая инструкция
для фетального монитора «Илифия»

мобильно

15-45 минут

отправка врачу

USONTEC

Подготовка к обследованию

1

App Store

Google Play

Скачайте приложение
Fetal Monitor Client

2

Зарядите прибор
минимум до 50%

3

Подключите датчики по цветовой маркировке. Стрелка соединения должна смотреть вверх.

Перед началом работы убедитесь, что прибор заряжен и готов к работе.

Установка УЗ-датчика
(для сердцебиения)

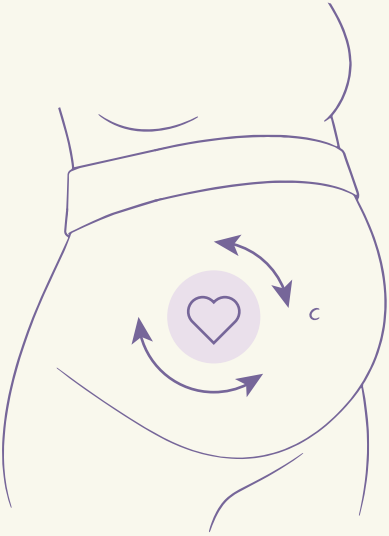

1. Нанесите гель на УЗ-датчик
2. Приложите УЗ-датчик к животу в области, которую обозначил лечащий врач
3. Медленно двигайте УЗ-датчик, пока не услышите чёткое сердцебиение
4. Закрепите УЗ-датчик ремнём вокруг живота

Датчик должен полностью прилегать к коже. Лучшее качество записи – при максимально чётком звуке сердцебиения.

Установка ТОКО-датчика
(для активности матки)

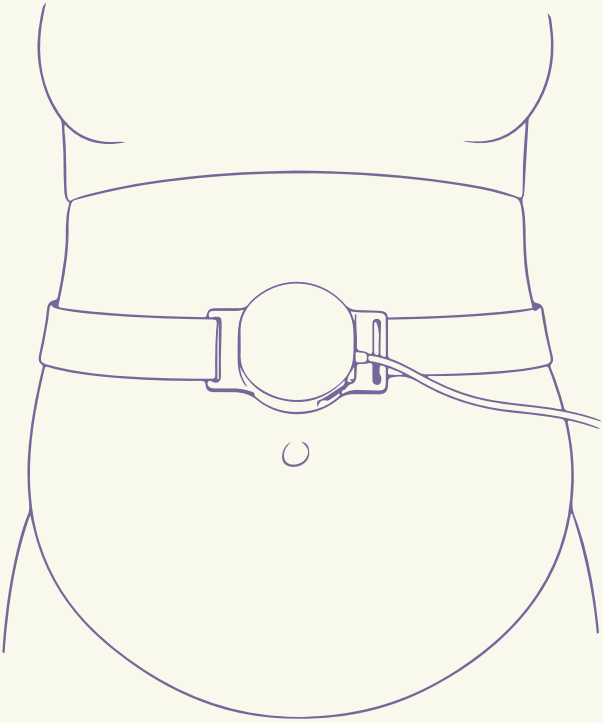

1. Разместите датчик примерно посередине, между пупком и верхней частью живота
2. Закрепите датчик ремнём вокруг живота
3. Отрегулируйте натяжение ремня так, чтобы прибор не сообщал об ошибке

Запись КТГ

Включите аппарат КТГ при помощи боковой кнопки.

Нажмите кнопку «ЗАПИСЬ» на экране монитора.

Запись

Идёт запись

На экране отображается время обследования, прибор анализирует качество сигнала автоматически.

Отмечайте шевеления

Нажимайте кнопку-маркер каждый раз, когда чувствуете движение малыша.

Критерий выполнен

Запись КТГ может быть остановлена принудительно, по истечении времени или остановится автоматически.

15-45 минут

Максимальная длительность записи

Отправьте результат врачу-координатору

Загрузка данных обследования

Нажмите в приложении: «Загрузка данных обследования».

Отправьте файл

Загрузите файл
и направьте по e-mail :
m.kostyukova@remediclinic.ru

Врач получает результат

Ваш врач-координатор проанализирует запись и свяжется с вами.

Данные защищены
и используются только
для медицинских целей.

Если возникли проблемы

Слабый сигнал

Прибор сообщает:
«проверьте положение УЗ-датчика».

Что делать: немного переместите УЗ-датчик, добейтесь более чёткого сердцебиения.

Проблема с ТОКО-датчиком

«Подтяните ремень»
Ремень слишком свободный

«Ослабьте ремень»
Ремень слишком тугой

После регулировки нажмите кнопку сброса ТОКО.

REMEDI
ИНСТИТУТ РЕПРОДУКТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ

При любой проблеме свяжитесь с врачом- координатором:
Костюкова Мария Евгеньевна

+ 7 (916) 339-78-01